

# 团 体 标 准

T/CVMA X6—2020

---

## 乙型脑炎病毒微滴式数字 RT-PCR 检测方法

Method of droplet digital RT-PCR for detection of japanese encephalitis virus

(征求意见稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

2020 - XX - XX 发布

2020 - XX - XX 实施

中国兽医协会 发布


## 前 言

本标准按 GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国兽医协会提出并归口。

本标准起草单位：上海市动物疫病预防控制中心。

本标准主要起草人：李鑫、鞠厚斌、赵洪进、王建、葛菲菲、杨德全、沈海潇、杨显超、刘健、陶田谷晟。

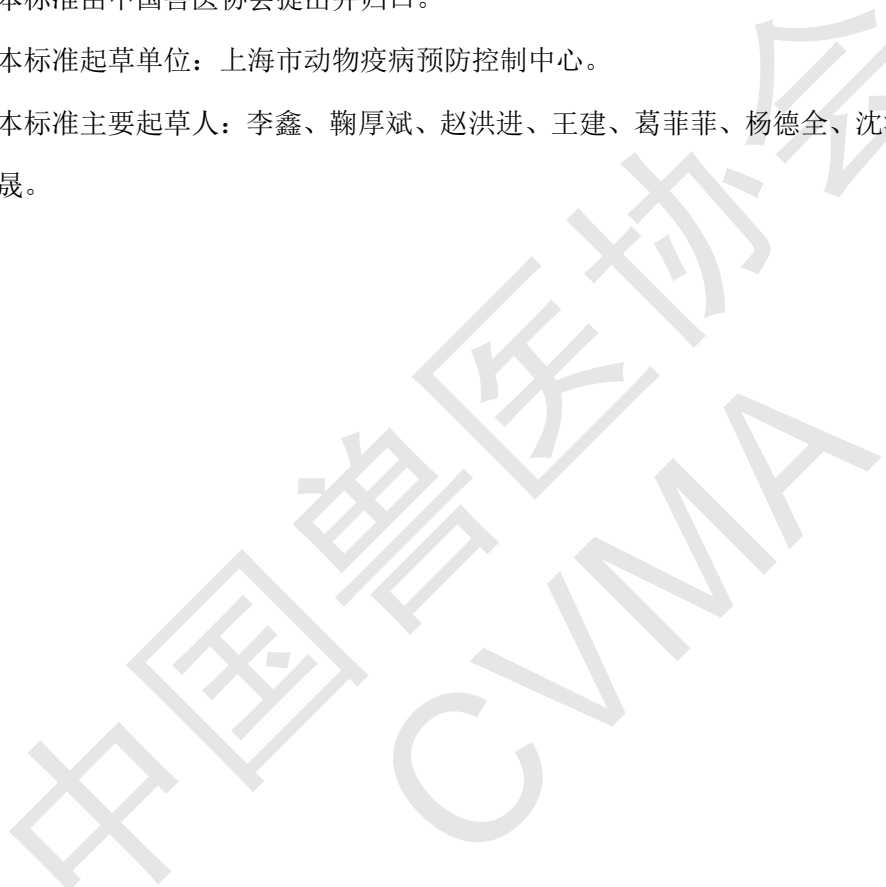

# 乙型脑炎病毒微滴式数字 RT-PCR 检测方法

## 1 范围

本标准规定了乙型脑炎病毒（Japanese Encephalitis Virus, JEV）微滴式数字RT-PCR检测的操作方法。

本标准适用于猪、马、牛、羊及犬的乙型脑炎病毒核酸的检测。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 541 兽医诊断样品采集、保存与运输技术规范

## 3 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

数字 RT-PCR: 数字反转录聚合酶链反应 (digital reverse transcript polymerase chain reaction)

BHQ1 无荧光淬灭基团 (black hole quencher-1)

FAM 羧基荧光素 (carboxyfluorescein)

RNA 核糖核酸 (ribonucleic acid)

## 4 原理

微滴式数字PCR (Droplet Digital PCR, ddPCR) 的技术原理是利用微滴化技术将一份反应体系分成数万个纳升级的微滴进行定量PCR检测，本质上是将传统定量PCR的一次检测变成数万次检测，提高了检测的灵敏度和精准度。微滴发生器可以将每一份扩增体系分成数万个均匀的纳升级微滴，每个微滴不含或者含有一个至数个待检核酸靶分子。每个微滴都将作为一个独立的PCR扩增体系，在PCR扩增仪上进行终点PCR扩增。利用微滴分析仪逐个对每个微滴进行检测，有荧光信号微滴判读为1，没有荧光信号微滴判读为0。然后根据泊松分布原理以及阳性微滴的比例，计算出待检靶分子的浓度或拷贝数。

## 5 试剂与耗材

### 5.1 引物和探针

上游引物 (JEV F): 5' - ACCAAGAAGTCTACGTCCAATATGG -3'

下游引物 (JEV R): 5' - TTGGACCGACACGGATCTC -3'

探针 (JEV P): 5' -FAM-TGCACGCGGACCAGGCATTC-BHQ1-3'

## 5.2 核酸提取试剂

宜选取针对提取病毒 RNA 的提取试剂盒。

## 5.3 数字 RT-PCR 反应试剂

宜按照不同的微滴式数字 PCR 平台的说明书选取其推荐的数字 RT-PCR 反应试剂盒。

## 6 仪器与设备

生物安全柜、PCR 扩增仪、数字 PCR 微滴发生器、数字 PCR 微滴分析仪、纯水仪、核酸定量仪、涡旋震荡仪。

## 7 操作步骤

### 7.1 样品采集及运输

采集动物的脑组织、血液等，具体要求按照 NY/T 541 执行。

### 7.2 RNA 提取

按照所选取的病毒 RNA 提取试剂盒说明书进行提取。

### 7.3 微滴式数字 RT-PCR 扩增方法

#### 7.3.1 微滴式数字 RT-PCR 体系配制

每个样品微滴式数字 RT-PCR 扩增设置 3 个平行。微滴式数字 RT-PCR 扩增体系配制如表 1。该步骤按照不同微滴式数字 PCR 平台的说明书进行操作。

表 1 微滴式数字 RT-PCR 扩增体系

试剂	终浓度	体积
酶混合液 <sup>a</sup>	1×	8 μL
JEV F+R (10 μmol/L)	0.9 μmol/L	1.8 μL
JEV P (10 μmol/L)	0.25 μmol/L	0.5 μL
RNA 模板	/	2 μL
无核酸酶水	/	7.7 μL
总体系	/	20 μL

注：使用微滴式数字 PCR 平台进行实验时，应依据不同微滴式数字 PCR 平台调整扩增体系的组分和最终体积，表中所列组分的终浓度不变。

<sup>a</sup> 微滴式数字 RT-PCR 扩增试剂。

### 7.3.2 微滴生成、数字 RT-PCR 扩增及结果读取

反应液配制后，使用微滴发生器对扩增体系进行微滴生成。微滴生成后，进行微滴式数字 RT-PCR 扩增。荧光分析步骤采用 FAM 单荧光通道，微滴式数字 RT-PCR 扩增程序如表 2 所示。

表 2 微滴式数字 RT-PCR 扩增程序

步骤	温度	持续时间	循环数
1	50 °C	20 min	1
2	95 °C	10 min	1
3	95 °C	30 s	40
4	55 °C	1 min	
5	98 °C	10 min	1
6	12 °C	60 min	1

注：升降温速率设置为 2.5 °C/s。

### 7.4 微滴式数字 RT-PCR 反应的对照

在进行微滴式数字 RT-PCR 实验时，应设置阳性对照、阴性对照与空白对照。以含有乙型肝炎病毒的 RNA 作为阳性对照；以未感染乙型肝炎病毒动物的组织混样基因组作为阴性对照；以无核酸酶水作为空白对照。各对照 RT-PCR 扩增体系中，除模板外，其余组分和 RT-PCR 扩增程序与 7.3.1 和 7.3.2 相同。

## 8 结果分析

### 8.1 实验成立条件

微滴式数字 RT-PCR 扩增结果，有效微滴数不得低于理论微滴数的 60%。阴性对照组和空白对照组均未检出阳性微滴，阳性对照有明显阳性微滴，且核酸拷贝数浓度  $\geq 10$  拷贝/ $\mu\text{L}$ ，则实验成立。

### 8.2 阈值设定

微滴式数字 RT-PCR 结果中，阳性微滴和阴性微滴明显分开，阈值设在阳性微滴和阴性微滴分开的区域。

### 8.3 结果判定

样品中检测出阳性微滴，且阳性核酸拷贝数浓度  $\geq 10$  拷贝/ $\mu\text{L}$ ，则判定为阳性。

样品中检测出阳性微滴，阳性核酸拷贝数浓度  $< 10$  拷贝/ $\mu\text{L}$ ，则需复检。若复检结果仍检测出阳性微滴，则判定为阳性，否则判定为阴性。

样品中未检出阳性微滴，则判定为阴性。